


钛合金阳极氧化色板 Color Selection Guide

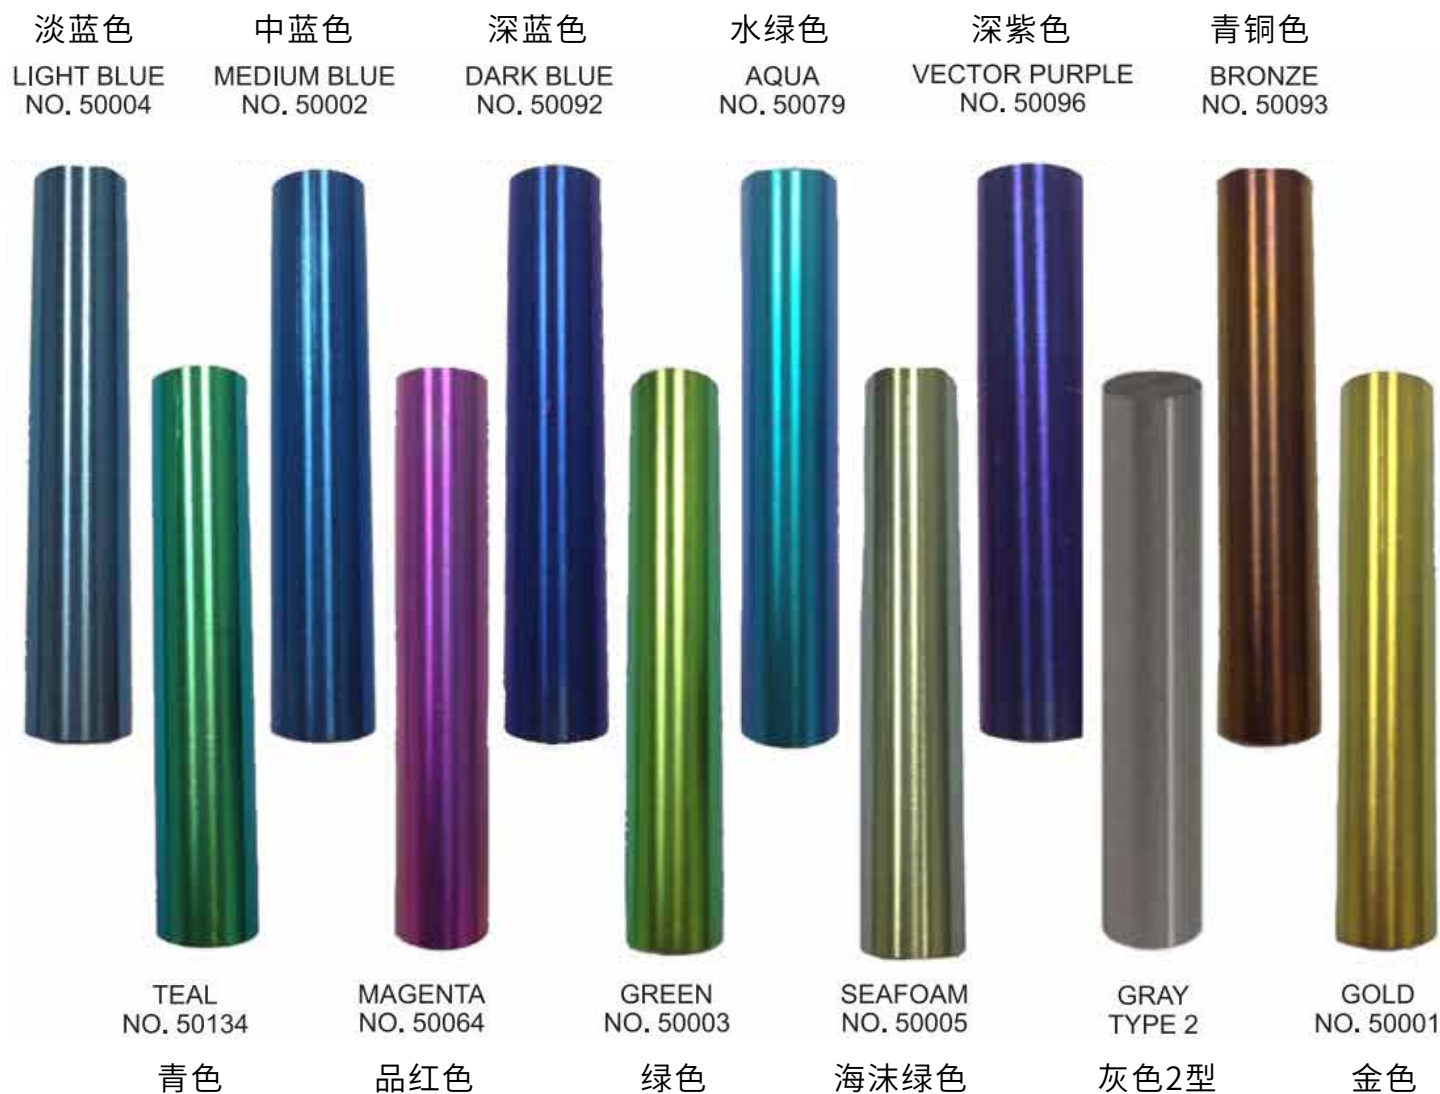

注：以上标准颜色仅供参考。受显示器类型、产品表面光洁度和其他因素的影响，颜色显示可能略有差异。如需彩色样品，请与我们联系。丹柯医疗还可以加工其他颜色及形状的产品。

在阳极氧化涂层的应用或阳极氧化后的基材产品中，可能存在其他影响因素。如需了解详细信息，请咨询我们的技术支持团队。